CYCLES LES PLUS UTILISES *(Liste complete dans le mode d'emploi)*

Cycle 1 : Simple nettoyage
Test d'étanchéité
Pré-net.
Nettoyage
Rinçage
Désinfection
Rinçage
Soufflage***
DUREE : 20* min.

Cycle 2 : Double nettoyage
Test d'étanchéité
Pré-net.
Nettoyage
Rinçage
Nettoyage
Rinçage
Désinfection
Rinçage
Soufflage***
DUREE : 22* min.

Cycle 4 : Désinfection sans nettoyage.
Test d'étanchéité
Pré-net.
Désinfection
Rinçage
Soufflage***
DUREE : 18* min.

Cycle 6 : Auto désinfection Après chaque programme quotidien et changement de filtres à eau et avant chaque programme si la machine n'a pas été utilisée depuis plus de 72H
Désinfection Bac de disconnexion
Désinfection Unité de préfiltration + Filtre 0.2µm à eau
Désinfection machine
Recirculation Horaires des circuits
Machine en veille Pour réutiliser la machine Appuyer sur F3
Soufflage des circuits internes
DUREE : 50 * min.

LES INSTRUCTIONS CONTENUES SUR CETTE FICHE NE DISPENSENT EN AUCUN CAS L'UTILISATEUR DE LIRE ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI.

LANCER UN CYCLE

Dès la fin de l'endoscopie, faire un prétraitement de l'endoscope avant mise en machine. En l'absence d'un protocole validé → voir mode d'emploi Chapitre 2.

Avec le N° d'endoscope, choisir la connectique appropriée et le connecter (Cf. doc "Choix des connectiques »)

→ Pour cycle 6 : Connecter

Départ menu d'accueil : Taper Main ou F1 pour y accéder.



Taper F3 et suivre attentivement les instructions sur l'afficheur.

"Lecture code barre "……" ⇒ saisie impérative avec le lecteur code barre sinon, la saisie est manuelle uniquement. En fin de saisie l'écran suivant doit apparaître.

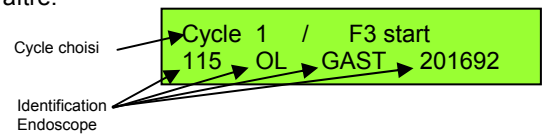

Fermer le capot sans forcer et taper F3 pour lancer le cycle.

Main **POUR RESAISIR LES DONNEES**

F1 **POUR INTERROMPRE LE CYCLE**

* Les durées des cycles peuvent varier en fonction du type d'endoscope et du colmatage des filtres (+/- 2min.)

*** Le séchage effectué par la machine est suffisant pour permettre la réutilisation de l'endoscope dans un court délai. En cas de stockage prolongé, sécher manuellement les canaux de l'endoscope à l'air médical.